

STS304で作られたショットグラスは、ガラス製の物とは違い割れる心配がないので、安心してお使いいただけます。



SHOT GLASS(4PCS)



主に、ソジュ（韓国焼酎）や日本酒、マッコリなどのアルコール飲料のグラスとして、お使いいただけます。

ステンレス仕様の為、保冷保温に優れており、冷から燗まで楽しめます。

メッシュポーチとセットなので場所を選ばずお使いいただけます。

持ち運びにとっても便利です。

ガラスにはレーザー加工を施しており、見た目も飽きない作りです。

【研磨剤の洗浄方法】

- ① キッチンタオルに食用油を使用して拭き取ってください。
- ② ベーキングソーダ（重曹）を振りかけ、柔らかいスポンジで拭きます。
- ③ 酢を沸騰したお湯に入れて殺菌および消毒をします。
- ④ 台所用洗剤を使用して、洗い流します。



【使用上の注意】

- 洗浄後はしっかりと乾かし、水滴を残さないようにしてください。
- 長時間液体を入れたまま放置せず、早めに飲み終えるか冷蔵庫で保管して下さい。錆の原因となる可能性があります。
- 他の金属製品と一緒に保管すると摩擦による傷がつくことがありますので、注意して下さい。

SHOT GLASS(4PCS)

KI24A008

¥4,400（税込）

- サイズ：60×60×40mm
- 容量：60ml
- 重量(1個あたり)：52g
- 素材：STS304
- 入数：4つ（メッシュポーチ付き）
- 生産国：韓国

食洗機：対応

IH調理：非対応

直火：非対応

Company's key products


Made in Korea

SHOT GLASS(4pcs)



SHOT GLASSES

SIZE INFO

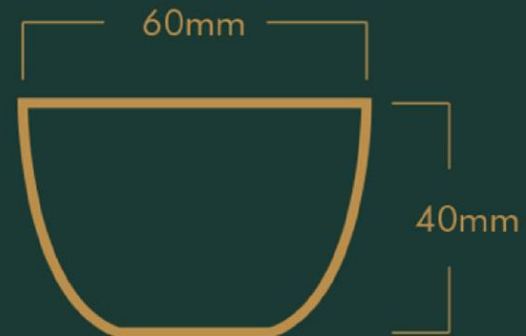

Certification details attached

有害物質が検出されなかったことを示す
認証詳細が、検査報告書に添付しています。

鉛
カドミウム
ニッケル
ヒ素
六価クロム

上記5種類は検出されませんでした。

the way to trust

KCL

9399-2579-3013-5933



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-110302K

2. 의뢰자

- 업체명 : 신원테크
- 주소 : 경기도 김포시 대곶면 소래로97번길 104-9

3. 시험기간 : 2020년 09월 21일 ~ 2020년 09월 28일

4. 시험성적서의 용도 : 참고용

5. 시료명 : 스테인리스 가구용기

6. 시험방법

(1) 식품용 가구 및 용기포장 공전

7. 시험결과

1) 스테인리스 가구용기

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비고
중금속 납(Pb)	mg/L	0.4 이하	(1)	불검출	-
중금속 카드뮴(Cd)	mg/L	0.1 이하	(1)	불검출	-
중금속 니켈(Ni)	mg/L	0.1 이하	(1)	불검출	-
중금속 비소(As.O.로서)	mg/L	0.2 이하	(1)	불검출	-
중금속 6가크롬(Cr ⁶⁺)	mg/L	0.1 이하	(1)	불검출	-

▶ 재질 : 금속재

----- 끝 -----

확인

작성일자

성명

채희민

기술책임자

성명

박경호

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부분을 탈취하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2020년 09월 28일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 06503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2587

총 1페이지 중 1페이지





Certification details attached

黄色ブドウ球菌に対して99.999%
の抗菌効果を持っている証明です。



한국분석시험연구원 (KATR)
Korea Analysis Test Researcher

경기도 고양시 통일로 140, A-336(삼송테크노밸리)
Tel : 1670 - 9936 | Fax : 02 - 6016 - 9711 | Email : katr@katr.re.kr

시험성적서

접수 번호 : KATRM201120-007	접수 일자 : 2020. 11. 20
성적서 번호 : KAAAM201208-007	발급 일자 : 2020. 12. 08
신청 회사 : 신용테크	용도 : 품질관리

주 소 : 경기도 김포시 대곶면 소래로97번길 104-9
담당자 : 전상준
제출처 :
시료명 : 스테인리스 기구용기

시험항목		시험결과	
		Control	Sample
JIS Z 2801:2010			
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (황색포도상구균) 접종균액의 농도	24시간 후 균수(CFU/mL) 항균활성치 2.5 X 10 ⁵ CFU/mL	1.5 X 10 ⁶	<10 5.2
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 (대장균) 접종균액의 농도	24시간 후 균수(CFU/mL) 항균활성치 2.5 X 10 ⁵ CFU/mL	2.2 X 10 ⁶	<10 5.3

※ 시료 정보: 재질 - 스테인리스 (STS304), 크기 - 50 X 50 mm

※ 표준 필름: 재질 - sterilized PP film, 크기 - 50 X 50 mm

※ 시료 처리: 24시간 전배양액 0.4 mL을 시료 위에 올린 뒤 표준 필름을 덮음

※ 항균활성치 = log₁₀((24시간 후 control 균수)/(24시간 후 시료 균수))

※ 항균효과: 항균활성치 2.0 이상



한국분석시험연구원

비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 KATR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.