STS304ステンレス製の液体も持ち運ぶことのできる
気密性に優れたスパイスキャニスターです

STS304ステンレスで作られているため、
耐久性、耐食性に優れています。

KINOXメスティンに収納可能

フライングバスケットと一緒に4つのスパイスキャニスターを保管できます。
スパイスキャニスターのみであれば1つを裏返しにすることで5つまで収納可能です。

蓋の内側には、シリコン製のパッキンを使用しているため
気密性に優れており、液体の調味料を持ち運ぶこともできます。
調味料からコーヒー豆なども入れることができ、
非常に汎用性が高い商品になっています。

【研磨剤の洗浄方法】

①キッチンタオルに食用油を使用して拭き取ってください。
②ベーキングソーダ（重曹）を振りかけ、柔らかいスポンジで拭きます。
③酢を沸騰したお湯に入れて殺菌および消毒をします。
④台所用洗剤を使用して、洗い流します。

【使用上の注意】

- 使用前にシリコーンのパッキンが正しく取り付けられているかを確認して下さい。
- 洗浄後はしっかりと乾かし、水滴を残さないようにしてください。
- 長時間液体を入れたまま放置せず、早めに使い切るか冷蔵庫で保管して下さい。錆の原因となる可能性がります。
- 他の金属製品と一緒に保管すると摩擦による傷がつくことがありますので、注意してください。

SPICE CANISTERS（2PCS）

KI24A037　　￥6,490（税込）

■　サイズ：84×67×55mm

■　重量（1個あたり）：83.5ｇ

■　素材：STS304

■　入数：2個

■　生産国：韓国

食洗機：対応

IH調理：非対応

直火　：非対応

Company’s key products

Made in Korea

SPICE CANISTERS

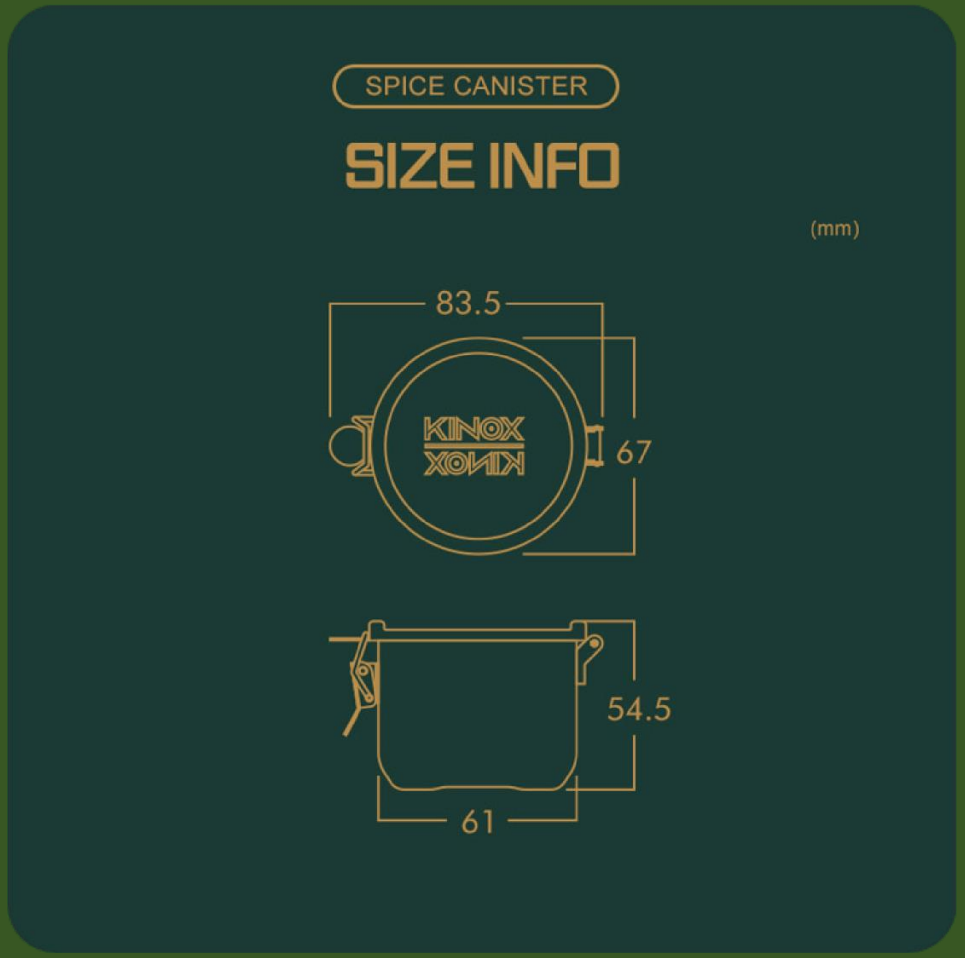

Certification details attached

有害物質が検出されなかったことを示す認証詳細が、検査報告書に添付しています。

鉛
カドミウム
ニッケル
ヒ素
六価クロム

上記5種類は検出されませんでした。

the way to trust KCL

9288-2579-3013-5933

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT20-110302K
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : 신용테크
   ○ 주 소 : 경기도 김포시 대곶면 소래로97번길 104-9
3. 시험기간 : 2020년 09월 21일 ~ 2020년 09월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 참고용
5. 시 료 명 : 스테인리스 기구용기
6. 시험방법
   (1) 식품용 기구 및 용기포장 공전
7. 시험결과

1) 스테인리스 기구용기

시험항목	단위	기준치	시험방법	시험결과	비 고
용출 납(Pb)	ng/L	0.4 이하	(1)	불검출	-
용출 카드뮴(Cd)	ng/L	0.1 이하	(1)	불검출	-
용출 니켈(Ni)	ng/L	0.1 이하	(1)	불검출	-
용출 비소(As:0로서)	ng/L	0.2 이하	(1)	불검출	-
용출 6가크롬(Cr^{6+})	ng/L	0.1 이하	(1)	불검출	-

▶ 재질 : 금속제

----- 끝 -----

확인	작성자 성 명	채희민	기술책임자 성 명	박경호

비고 :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2020년 09월 28일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 08503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 (가산동) ☎ (02)2102-2587

총 1페이지 중 1페이지

Certification details attached

黄色ブドウ球菌に対して99.999%
の抗菌効果を持っている証明です。

한국분석시험연구원 (KATR)
경기도 고양시 통일로 140, A-336(삼송테크노밸리)
Tel : 1670 - 9936 I Fax : 02 - 6016 - 9711 I Email : katr@katr.re.kr

시험성적서

접 수 번 호	: KATRM201120-007	접 수 일 자	: 2020. 11. 20
성적서 번호	: KAAAM201208-007	발 급 일 자	: 2020. 12. 08
신 청 회 사	: 신용테크	용 도	: 품질관리

주 소 : 경기도 김포시 대곶면 소래로97번길 104-9
담 당 자 : 전상준
제 출 처 :
시 료 명 : 스테인리스 기구용기

시험항목		시험결과 Control	시험결과 Sample
JIS Z 2801:2010			
Staphylococcus aureus	24시간 후 균수(CFU/mL)	1.5 X 10^6	<10
ATCC 6538 (황색포도상구균)	항균활성치		5.2
접종균액의 농도	2.5 X 10^5 CFU/mL		
Escherichia coli	24시간 후 균수(CFU/mL)	2.2 X 10^6	<10
ATCC 8739 (대장균)	항균활성치		5.3
접종균액의 농도	2.5 X 10^5 CFU/mL		

※ 시료 정보: 재질 – 스테인리스 (STS304), 크기 – 50 X 50 mm
※ 표준 필름: 재질 - sterilized PP film, 크기 - 50 X 50 mm
※ 시료 처리: 24시간 전배양액 0.4 mL을 시료 위에 올린 뒤 표준 필름을 덮음
※ 항균활성치 = $\log_{10}$((24시간 후 control 균수)/(24시간 후 시료 균수))
※ 항균효과: 항균활성치 2.0 이상

한국분석시험연구원

비고 1. 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 KATR의 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.